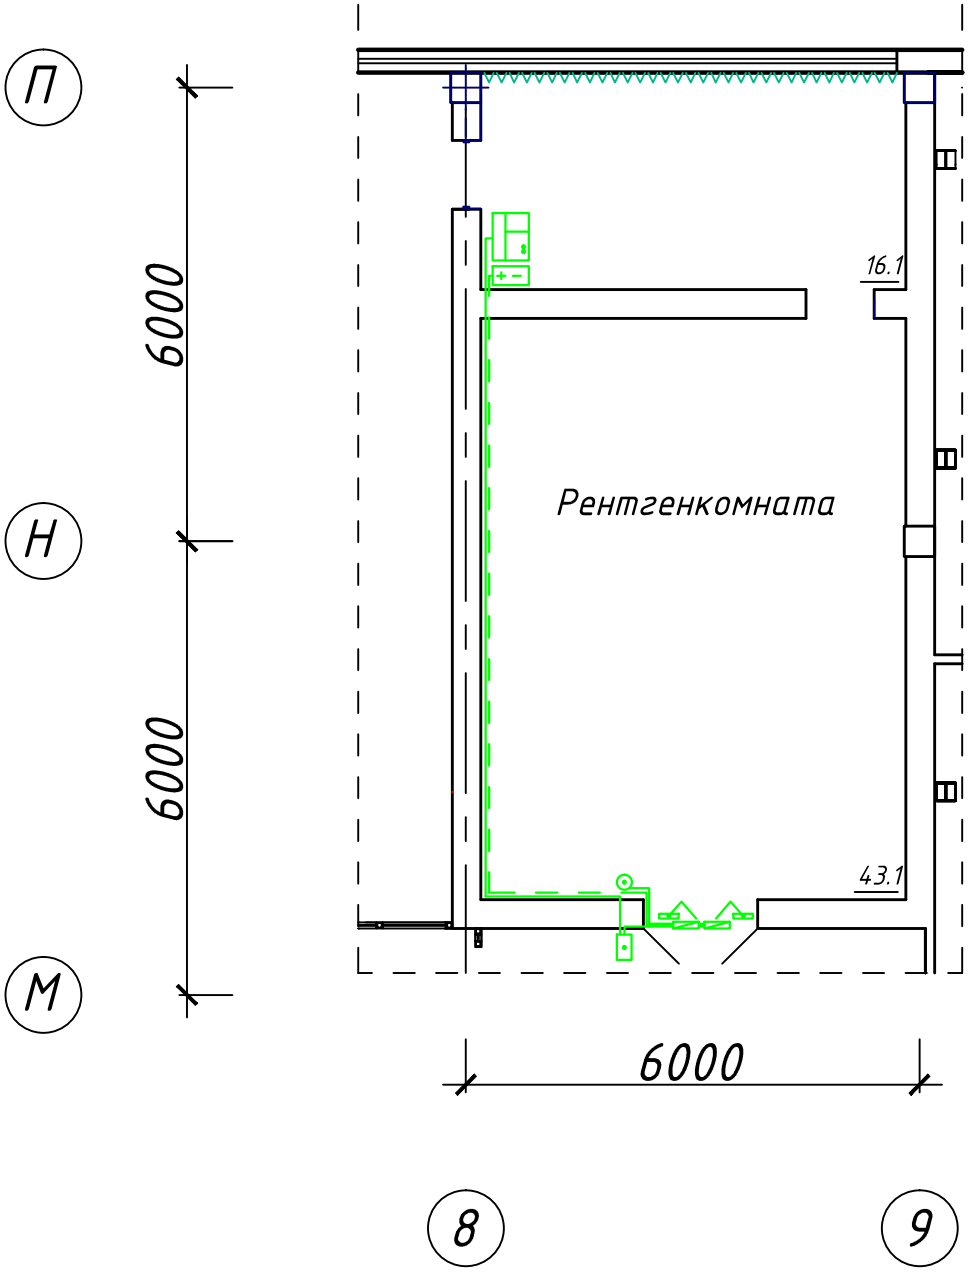


1. Конструкции стен, перекрытий и перегородок должны обеспечивать ослабление рентгеновского излучения до допустимых величин. Толщина свинцового листа h=1500 мм.
2. Все металлические конструкции, трубопроводы, воздуховоды, расположенные в зоне рентгеновского излучения, должны быть заземлены.

						32/12-АР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.					11.12	Рентгенкомната	Стадия: Р
Нач.отд.					11.12		Лист 1
Н.контр.					11.12		Листов 1

Формат А4